

NAOMI-CTシリーズ セファロ拡張タイプ



176万円 (税込)



■ 正面・側方・手根骨 各種撮影用途に対応

線状に画像を取得していくスキャン方式ではなく、
約1.5秒で画像を取得するワンショット方式で撮影。
低線量で患者さんの動きによるブレが少ない画像を取得できます。
内科等で使用されているNAOMIセンサーを搭載。

セファロ撮影画像




正面



側方

NAOMI-CTシリーズ セファロ拡張タイプ

幅 1,184mm × 奥行 1,900mm × 高さ 1,970mm

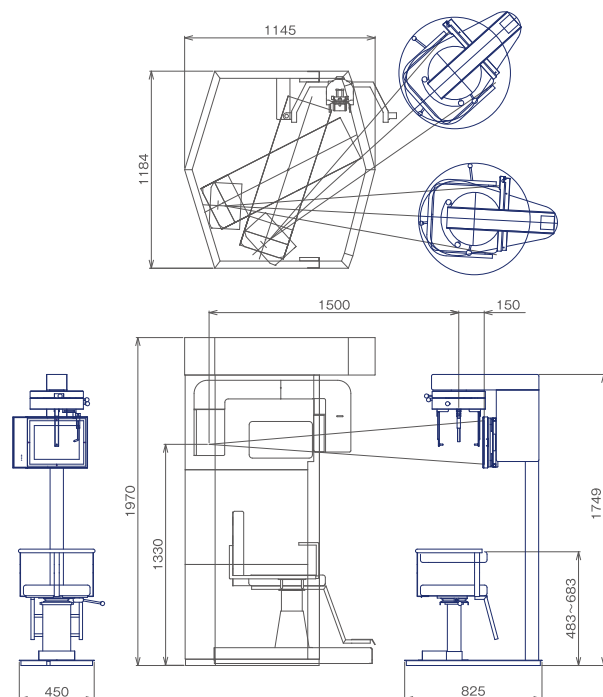

〈セファロ部分〉 ■重量：61kg ■寸法：W450×D825×H1,749mm

■電 源：AC 100~240V

■ 撮影画像サイズ

- ・側 面：324×261 mm
- ・正 面：324×261 mm
- ・手根骨：324×261 mm


■ 撮影画像解像度

- ・側 面：3,240×2,610 pixel (254dpi)
- ・正 面：3,240×2,610 pixel (254dpi)
- ・手根骨：3,240×2,610 pixel (254dpi)


セファロ配置例

※X線室等の医院環境によって寸法が異なります
詳しくはお問い合わせください


A タイプ

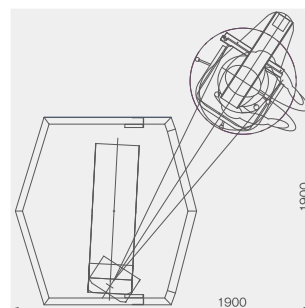

B タイプ

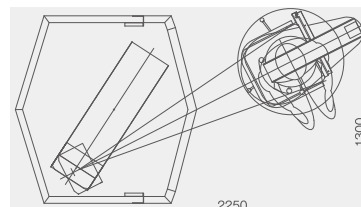

C タイプ

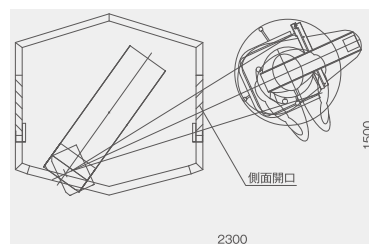

■画素サイズ：0.1×0.1 mm

■分 解 能：4.0 lp/mm

■軟組織フィルター：あり

■撮影時間：0.2~2.0 秒

■像拡大率：1.1 倍（手指骨は 1.01 倍）

■階 調：12bit



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_250415_Ml_ct_optcephalo_clg